Guía de adaptación
de lentes esclerales MINI en

5 pasos

1 Medir
HVID
(Diámetro Horizontal de Iris Visible)

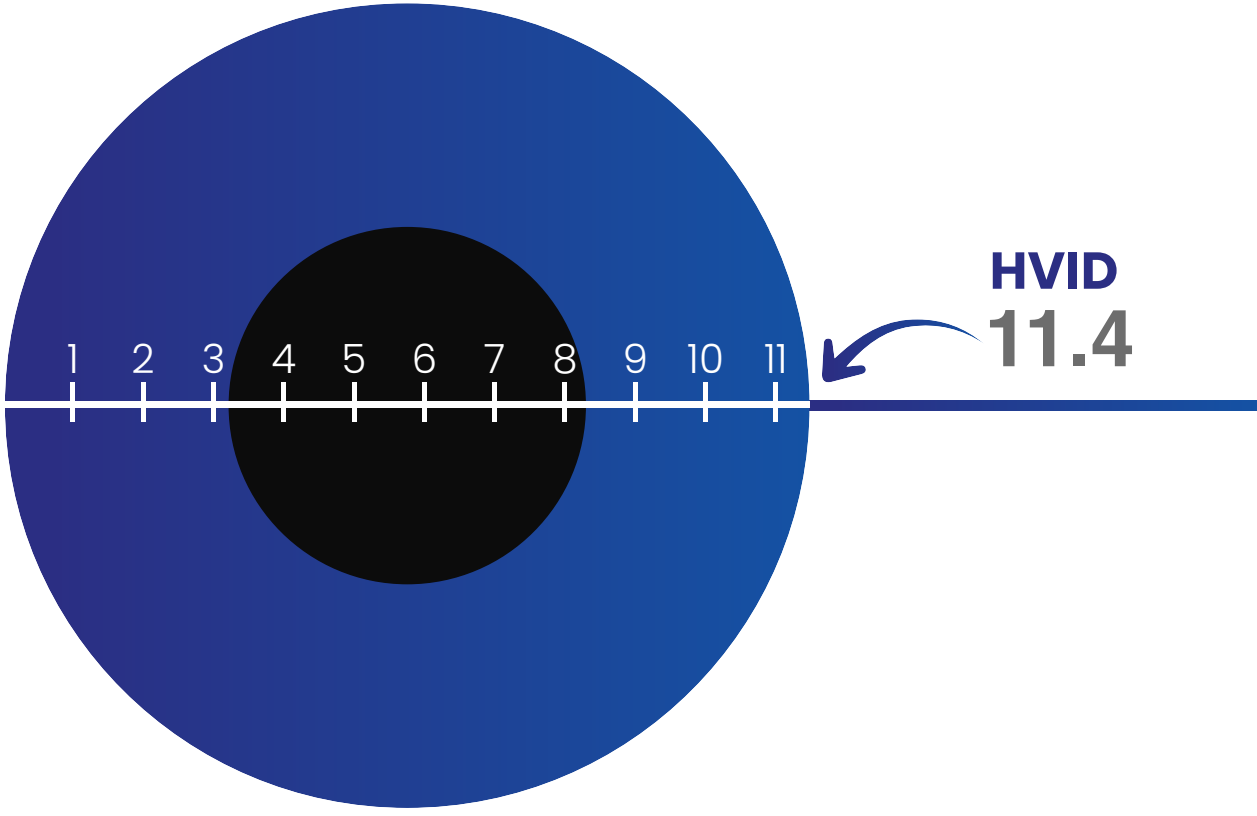

Selecciona
el lente
de acuerdo al diámetro del iris

HVID	Selección de fila
10.8 a 11.5	Fila diámetro 14.2
11.5 a 13.0	Fila diámetro 14.9

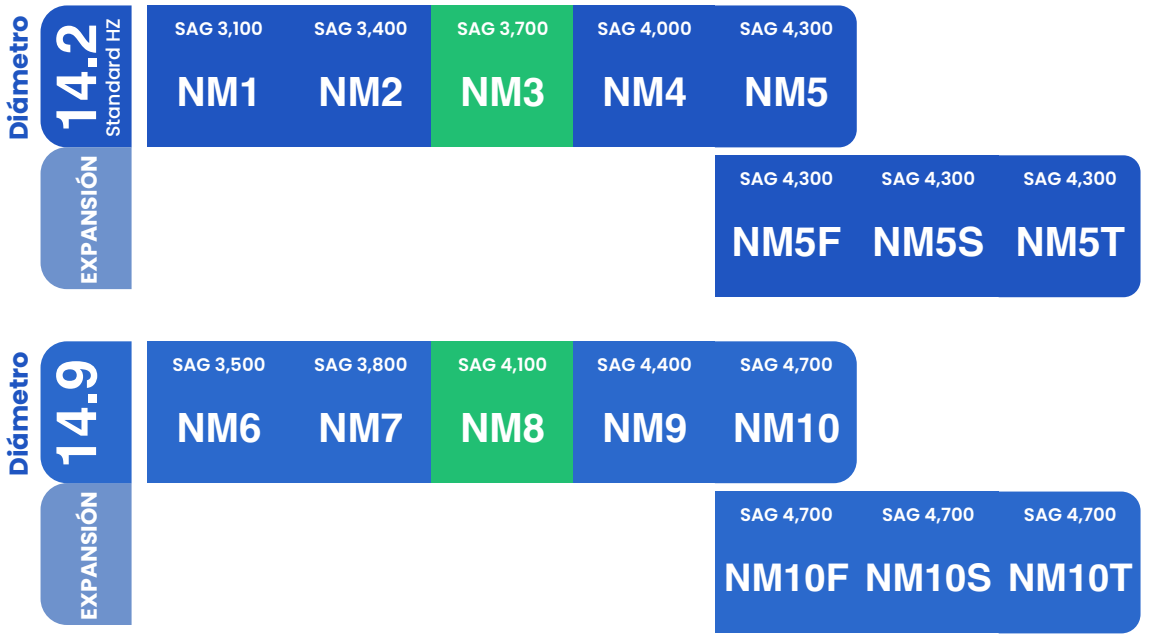

HVID
11.4

Seleccionar los lentes resaltados en verde en la fila o la curva base más cercana a la Queratomía Plana

Diámetro
14.2
Lente NM3

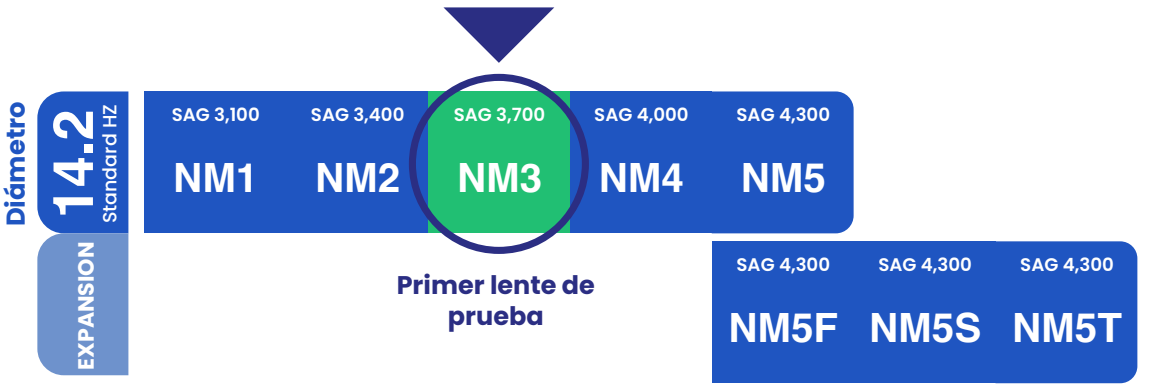

Selecciona
el lente de prueba
y colócalo en tu paciente

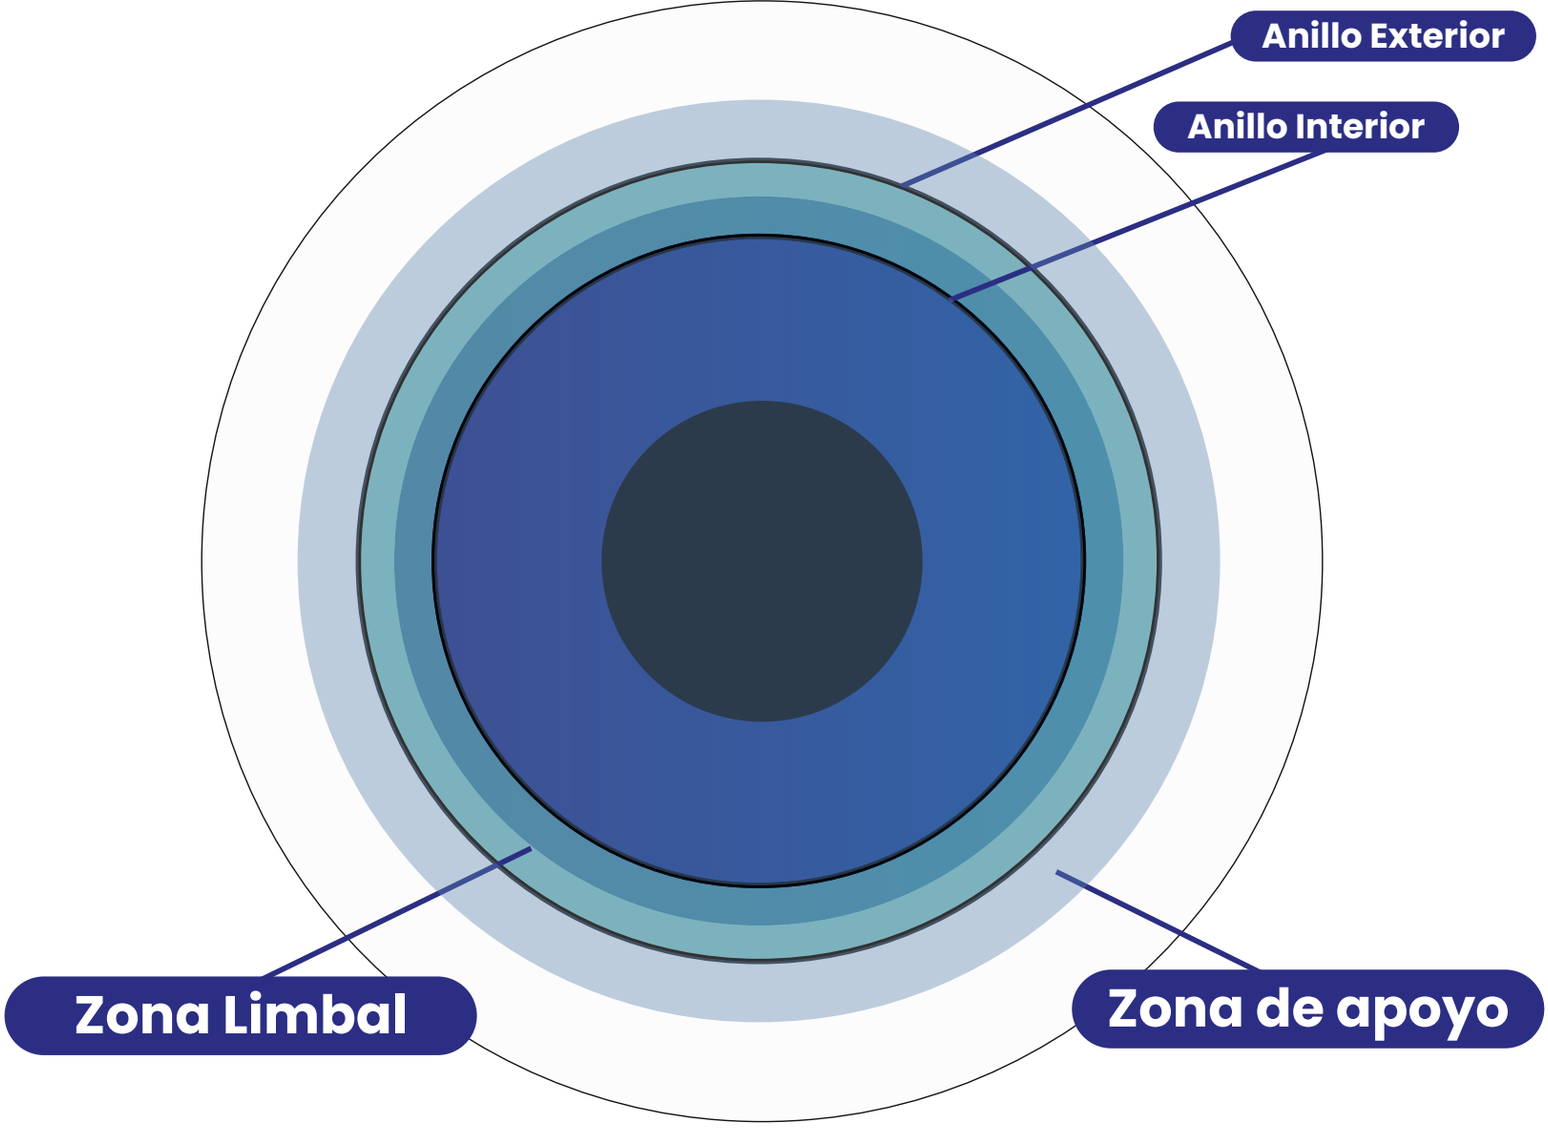

La zona de limbal se sitúa entre los dos anillos láser, mientras que la zona de apoyo se encuentra entre el anillo exterior y el borde del lente.

Evaluación de Diámetro

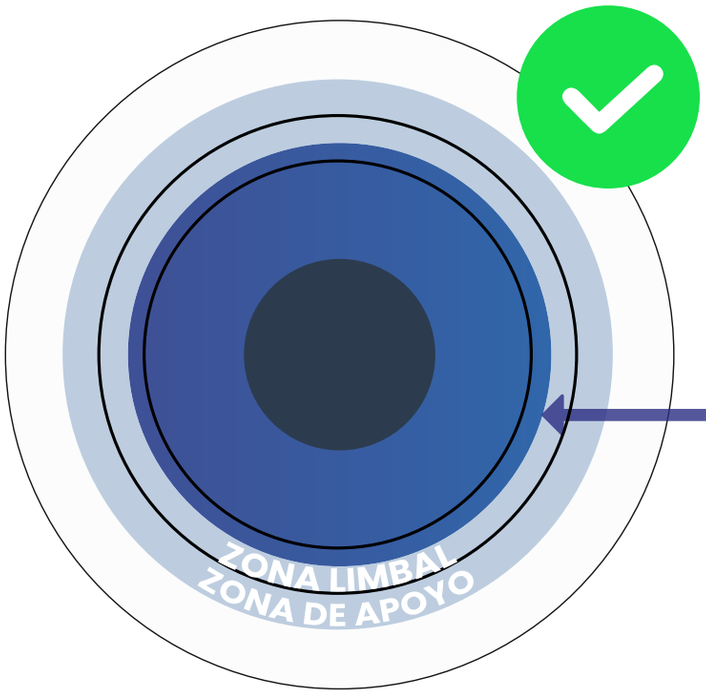

Tamaño Ideal

El Iris debe situarse entre los anillos láser en la Zona Limbal.

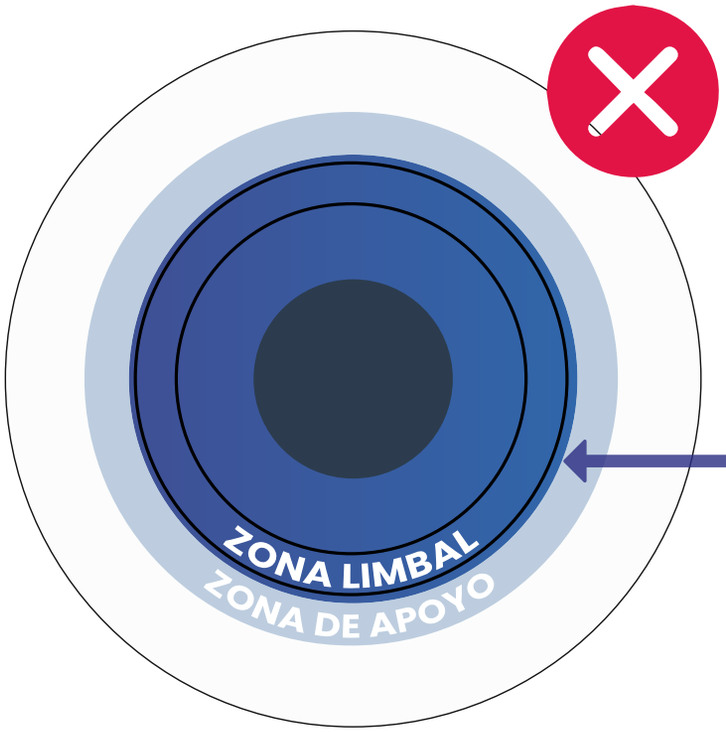

Demasiado pequeño

El Iris está fuera de la Zona Limbal

Incrementar Diámetro

Diámetro 14.2 Standard HZ	SAG 3,100 NM1	SAG 3,400 NM2	SAG 3,700 NM3	SAG 4,000 NM4	SAG 4,300 NM5
EXPANSIÓN				SAG 4,300 NM5F	SAG 4,300 NM5S / SAG 4,300 NM5T
Diámetro 14.9 Standard HZ	SAG 3,500 NM6	SAG 3,800 NM7	SAG 4,100 NM8	SAG 4,400 NM9	SAG 4,700 NM10
EXPANSIÓN				SAG 4,700 NM10F	SAG 4,700 NM10S / SAG 4,700 NM10T

Diámetro 14.2 Lente NM3 → Diámetro 14.9 Lente NM3

Moverse una Fila Abajo

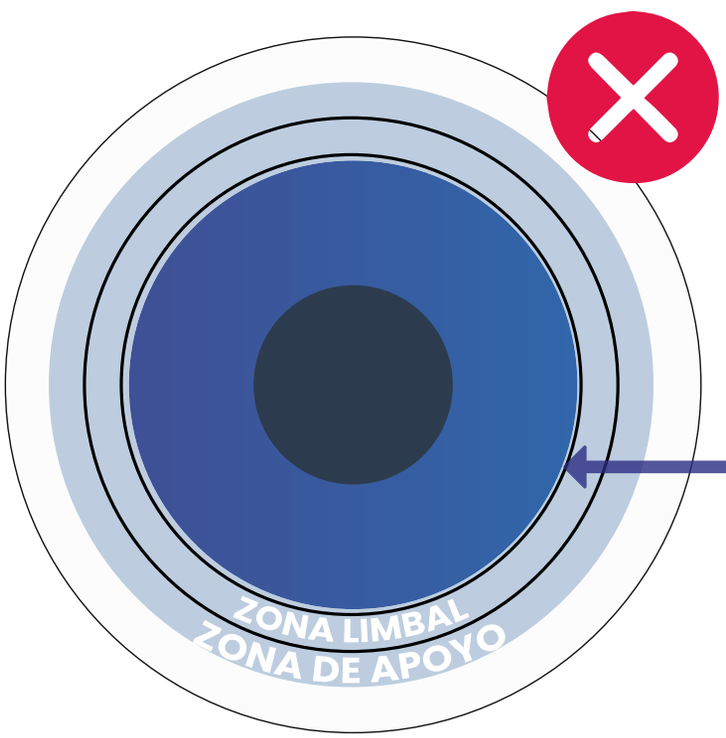

Demasiado grande

El Iris está antes de la Zona Limbal

Reducir Diámetro

Diámetro 14.2 Standard HZ	SAG 3,100 NM1	SAG 3,400 NM2	SAG 3,700 NM3	SAG 4,000 NM4	SAG 4,300 NM5
EXPANSIÓN				SAG 4,300 NM5F	SAG 4,300 NM5S / SAG 4,300 NM5T
Diámetro 14.9 Standard HZ	SAG 3,500 NM6	SAG 3,800 NM7	SAG 4,100 NM8	SAG 4,400 NM9	SAG 4,700 NM10
EXPANSIÓN				SAG 4,700 NM10F	SAG 4,700 NM10S / SAG 4,700 NM10T

Diámetro 14.9 Lente NM3 → Diámetro 14.2 Lente NM3

Demasiado pequeño | **Tamaño Ideal** | **Demasiado grande**

2 Ajusta la ságita

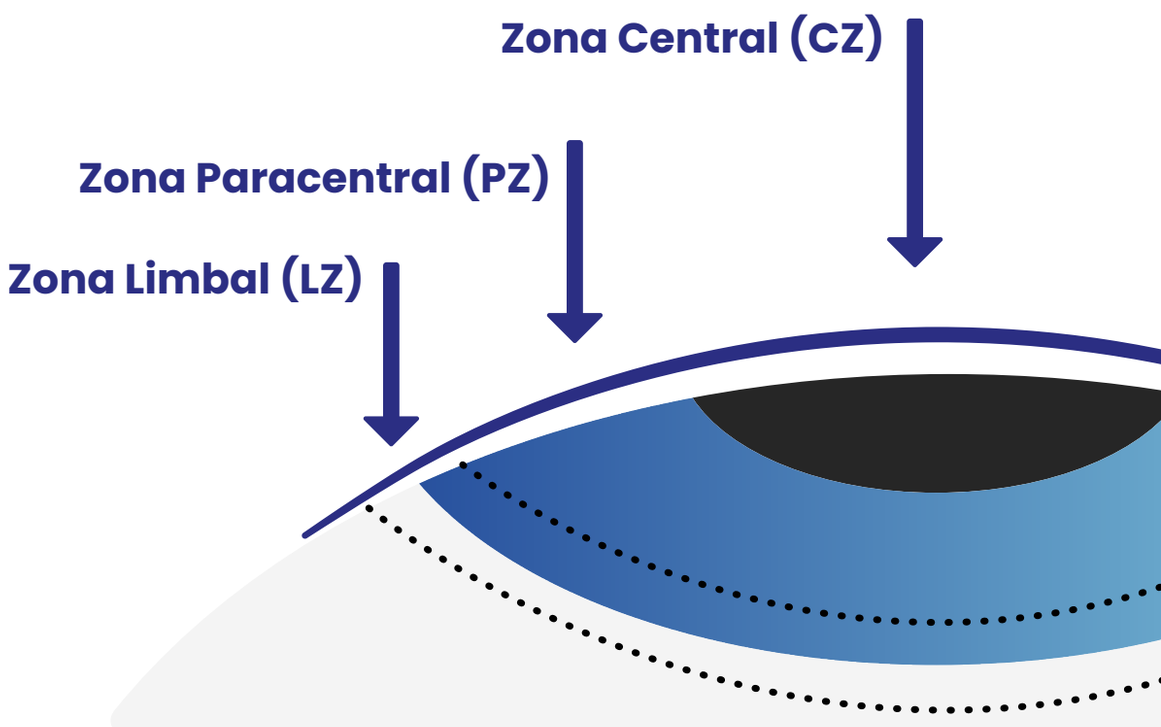

Ságita Ideal

La holgura central debe ser aproximadamente de 200 micras.

(después de 15 a 20 minutos de haberse asentado el lente)

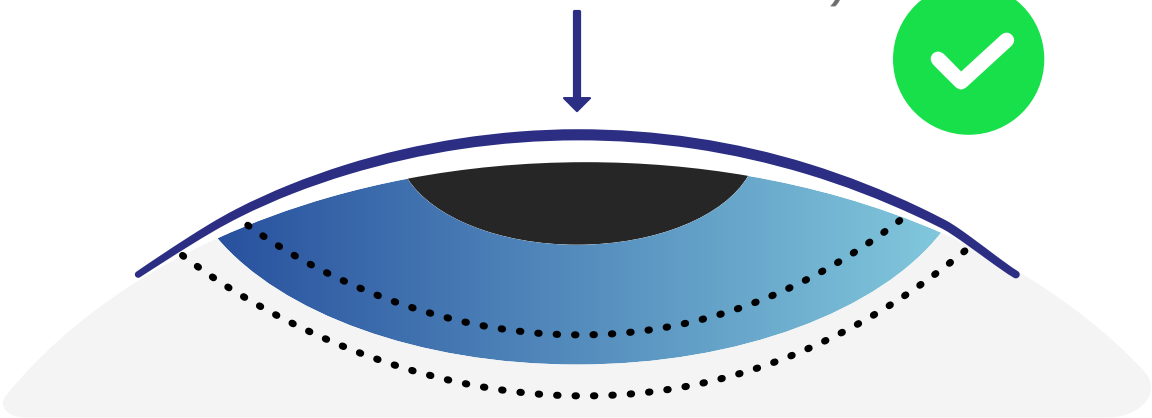

Espacio libre excesivo

Toque

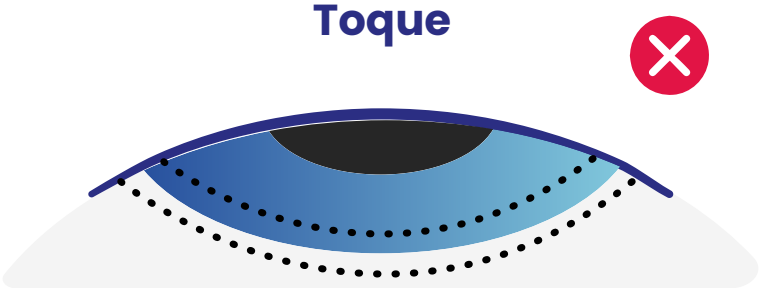

Reducir la Ságita

Holgura central excesiva

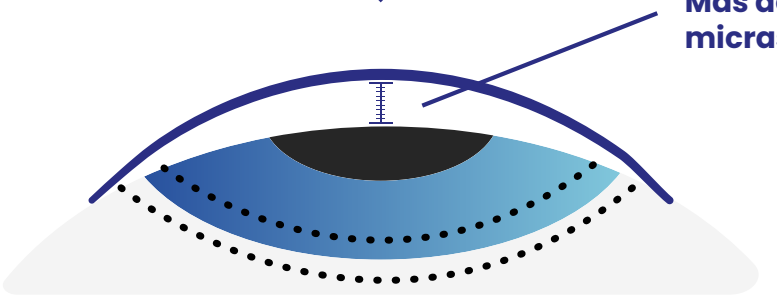

Toma el lente izquierdo del lente previamente seleccionado para reducir la ságita y tomar sobre refracción.

Reducir la Ságita

Diámetro					
14.2 Standard HZ	SAG 3,100 NM1	SAG 3,400 NM2	SAG 3,700 NM3	SAG 4,000 NM4	SAG 4,300 NM5
EXPANSION				SAG 4,300 NM5F	SAG 4,300 NM5S	SAG 4,300 NM5T

Diámetro					
14.9	SAG 3,500 NM6	SAG 3,800 NM7	SAG 4,100 NM8	SAG 4,400 NM9	SAG 4,700 NM10
EXPANSION Standard HZ				SAG 4,700 NM10F	SAG 4,700 NM10S	SAG 4,700 NM10T

Aumentar la Ságita

Zona central con Toque

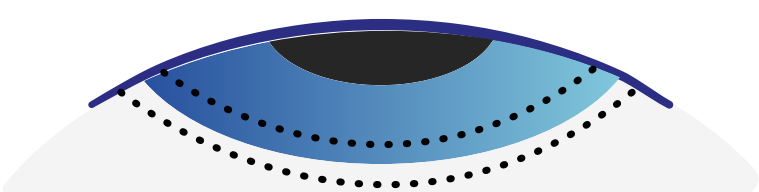

Aumentar la Ságita

Toma el lente derecho del lente previamente seleccionado para incrementar la ságita y tomar sobre refracción.

Diámetro					
14.2 Standard HZ	SAG 3,100 NM1	SAG 3,400 NM2	SAG 3,700 NM3	SAG 4,000 NM4	SAG 4,300 NM5
EXPANSION				SAG 4,300 NM5F	SAG 4,300 NM5S	SAG 4,300 NM5T

Diámetro					
14.9	SAG 3,500 NM6	SAG 3,800 NM7	SAG 4,100 NM8	SAG 4,400 NM9	SAG 4,700 NM10
EXPANSION				SAG 4,700 NM10F	SAG 4,700 NM10S	SAG 4,700 NM10T

Zona Limbal con Toque

Ordenar aumento de Zona Limbal o incrementar diámetro

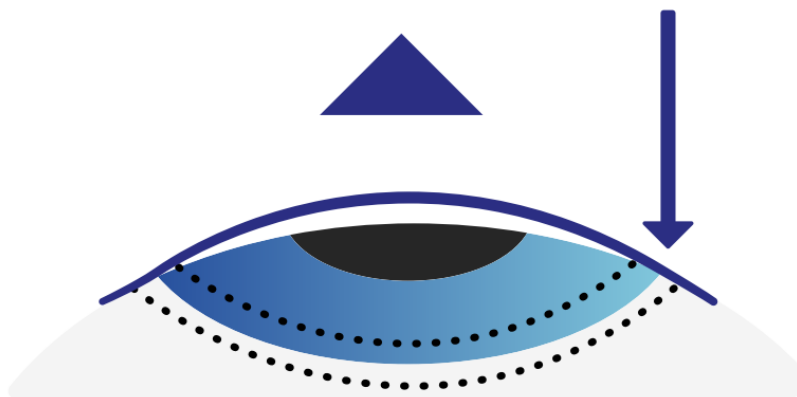

Zona Limbal (LZ) Standard → Zona Limbal (LZ) 1 PLUS

Diámetro 14.2 → Diámetro 14.9

Tomar Sobre refracción

Cuando la holgura sea aproximada a 200 micras y con el lente de contacto puesto.

Precaución

No tomar sobre refracción cuando la holgura sea excesiva

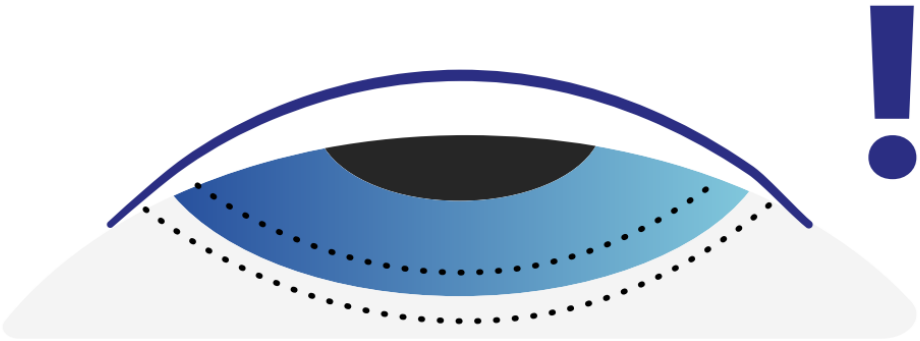

3 Evaluar la zona háptica

Compresión de los vasos sanguíneos

Blanqueamiento 360°

Evalúe después de
15 a 20 minutos

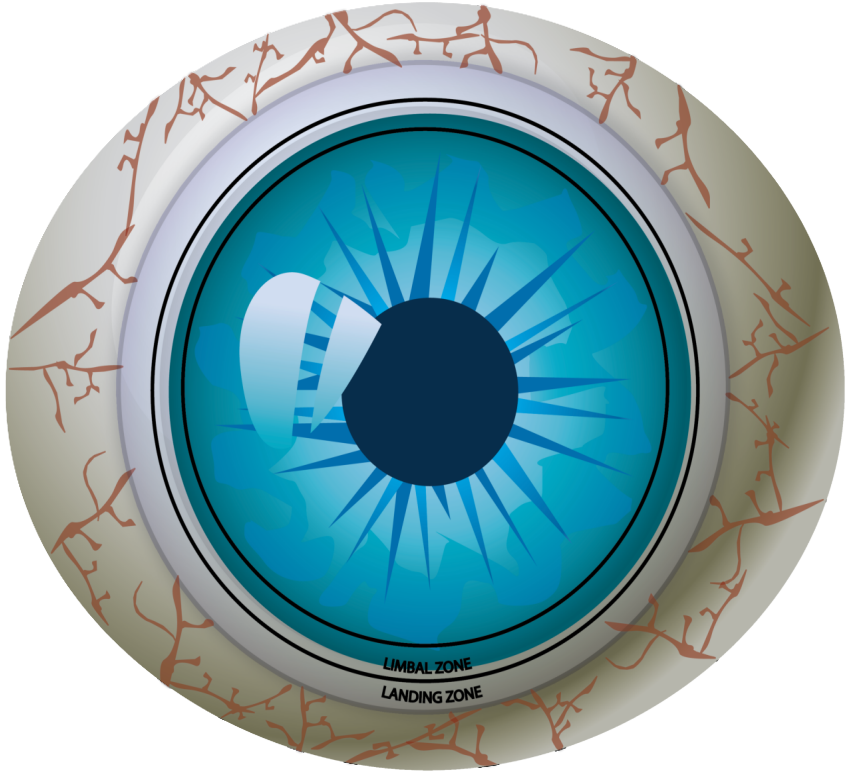

Seleccionar un borde Plano en el set

(FLAT)

Diámetro						
14.2 Standard HZ	SAG 3,100 NM1	SAG 3,400 NM2	SAG 3,700 NM3	SAG 4,000 NM4	SAG 4,300 NM5	
EXPANSION					SAG 4,300 NM5F	SAG 4,300 NM5S	SAG 4,300 NM5T

Diámetro						
14.9 Standard HZ	SAG 3,500 NM6	SAG 3,800 NM7	SAG 4,100 NM8	SAG 4,400 NM9	SAG 4,700 NM10	
EXPANSION					SAG 4,700 NM10F	SAG 4,700 NM10S	SAG 4,700 NM10T

Opción Háptica Estrecha

Elevación del borde 360°

Burbujas 360°

Seleccionar un borde estrecho en el set

(STEEP)

Diámetro								
14.2 Standard HZ	SAG 3,100 NM1	SAG 3,400 NM2	SAG 3,700 NM3	SAG 4,000 NM4	SAG 4,300 NM5			
EXPANSION					SAG 4,300 NM5F	SAG 4,300 NM5S	SAG 4,300 NM5T

Diámetro								
14.9 Standard HZ	SAG 3,500 NM6	SAG 3,800 NM7	SAG 4,100 NM8	SAG 4,400 NM9	SAG 4,700 NM10			
EXPANSION					SAG 4,700 NM10F	SAG 4,700 NM10S	SAG 4,700 NM10T

Compresión de los vasos sanguíneos

Blanqueamiento en un solo meridiano

Evalúe después de
15 a 20 minutos

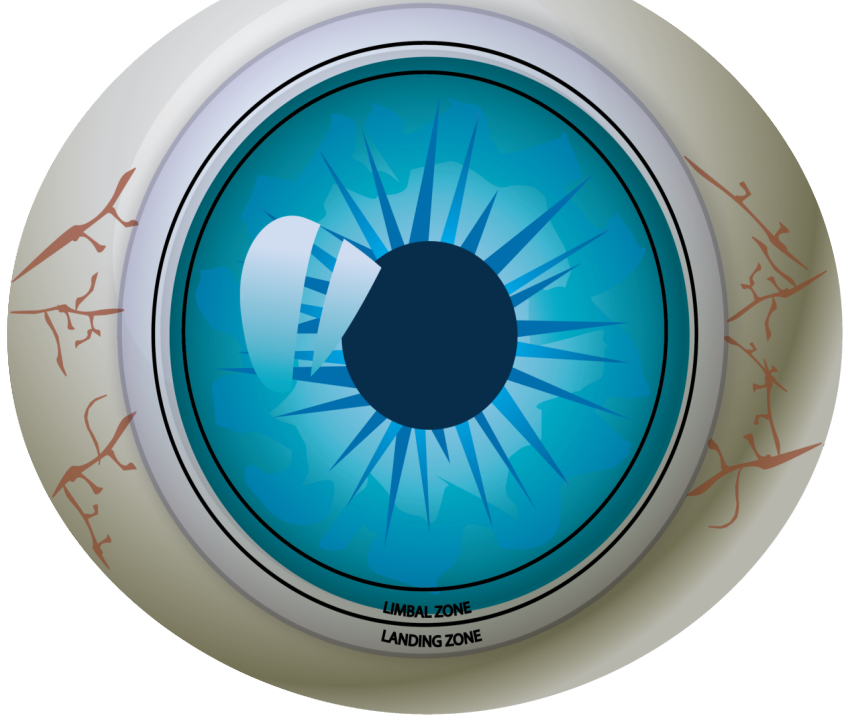

Opción Háptica Tórica

Elevación del borde en un solo meridiano

Burbujas en un solo meridiano

Seleccionar un borde Tórico en el set

(TORIC)

4 Ajustar
Zona Háptica/Paracentral

Zona Háptica

*Si los lentes apoyan antes de la zona limbal ordene un diámetro mayor

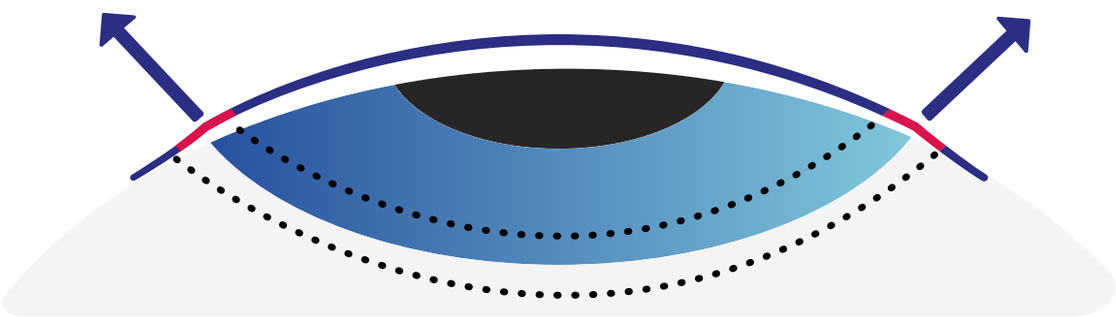

Zona Limbal (LZ) Standard → **Zona Limbal (LZ) 1 PLUS**

Zona Paracentral

*La zona paracentral incrementará automáticamente con el cambio de ságita.

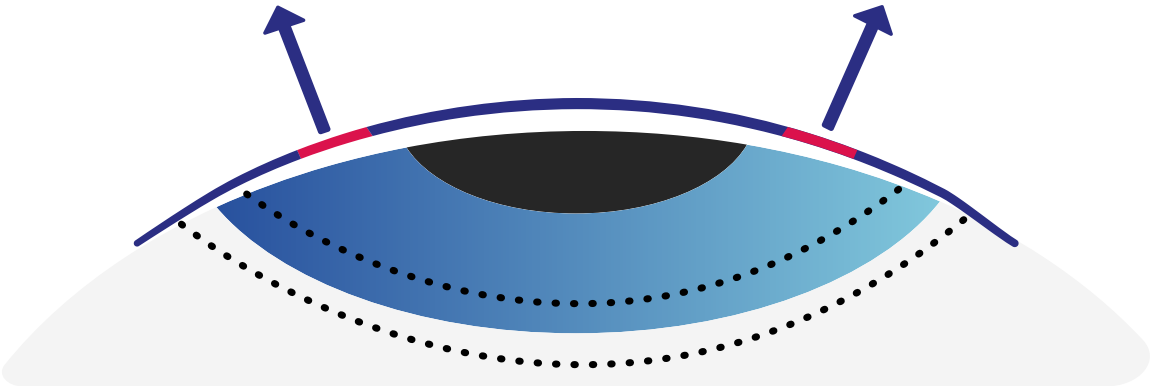

Llamar y preguntar por cambio de holgura adicional

5 Ordena tus lentes

Contáctanos
para realizar tu pedido

Opti | Representaciones